Accessoires

- Appareil avec câble inséré, carte à puce et piles incorporées
- Etui de protection avec ceinture réglable
- Electrodes autoadhésives
- Formulaire de demande, carnet du patient et mode d'emploi
- Collier de serrage pour le renvoi

Renvoi

Une fois les enregistrements terminés, veuillez nous renvoyer l'appareil sans débrancher le câble, la carte à puce, l'étui de protection, la ceinture ainsi que le formulaire de demande et le carnet du patient.

Soit

- via le Service clientèle, que vous pouvez joindre chez Viollier de votre région, ou
- via la poste

Pour le renvoi du coffret veuillez :

- retirer l'étiquette de la fenêtre transparente et la retourner de façon à ce que l'adresse 'Viollier AG' soit visible, puis la remettre dans la fenêtre transparente
- fermer le coffret avec le collier de serrage joint
- Viollier prend en charge les frais de port

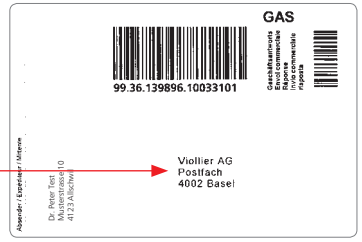

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information :
T +41(0)61 486 11 11
F +41(0)61 486 12 18
kardiologie@viollier.ch

Viollier AG | Postfach | 4002 Basel
www.viollier.ch | Détail comme vision

© by Viollier AG / 11.2012 / 6100

STS 0292

VIOLLIER

ECG de 24h

Mode d'emploi

Informations importantes

1. Ne pas mettre l'appareil en marche tant qu'il n'a pas été mis en place sur le patient. Ne pas effectuer d'enregistrement test au préalable. L'appareil ne peut pas être mis en marche une seconde fois.
2. Ne prêtez pas attention à la lumière LED clignotante bleue, car elle n'a aucune importance.
3. Un bip sonore continu retentit lorsque la carte à puce se détache pendant l'enregistrement. Réinsérer la carte.
4. Débrancher l'appareil avant de retirer les électrodes.
5. Laisser les piles dans l'appareil, ne jamais les retirer.
6. Les téléphones portables et les sources électromagnétiques puissantes peuvent influencer la qualité de l'enregistrement.

Carnet du patient :
Veuillez attirer l'attention du patient sur l'importance diagnostique d'un carnet correctement rempli.

- noter le début et la fin de l'enregistrement en précisant la date et l'heure
- inscrire la date et l'heure des symptômes, des activités inhabituelles, de la prise et du nom de médicaments et des phases de sommeil

VIOLLIER

Patientenprotokoll
Carnet du patient
Diario del paziente

24h-EKG | ECG da 24h | ECG delle 24h

Event-EKG (7 Tage) | ECG événementiel (7 jours) | ECG degli episodi (7 giorni)

24h-Blutdruck | Tension artérielle de 24h | Profilo pressorio delle 24h

Nächtliche Pulsoxymetrie | Pulsoxymétrie nocturne | Pulsossimetria notturna

Sont absolument nécessaires pour l'identification et l'analyse :

- les coordonnées du patient
- la date et l'heure exacte du début de l'enregistrement notées par vos soins
- le numéro de l'appareil et de la puce inscrit par Viollier sur le formulaire de demande d'analyses

*Données importantes			N° du chip	052
Appareil posé le, date		20	N° du brassard ou de l'accu	
Début de l'enregistrement		h	N° du capteur nasal	
N° de l'appareil	010		N° du capteur digital	

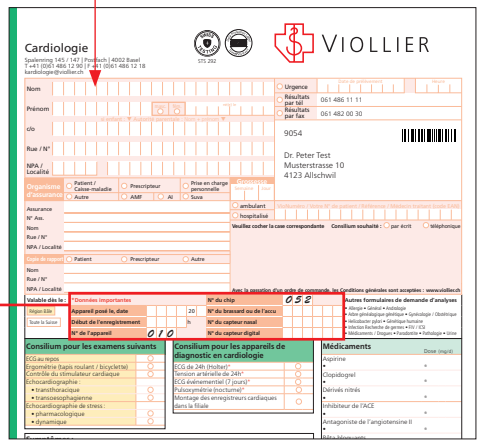
Cardiologie

VIOLLIER

Important : Veuillez utiliser uniquement le formulaire de demande joint, sur lequel figure déjà votre adresse.

Mise en place de l'appareil

Mise en place de l'appareil

1. Dégraisser la peau à l'alcool et, si nécessaire, raser les poils afin que les électrodes adhèrent de façon optimale à la peau.
2. Placer les électrodes autoadhésives comme indiqué sur la photo.

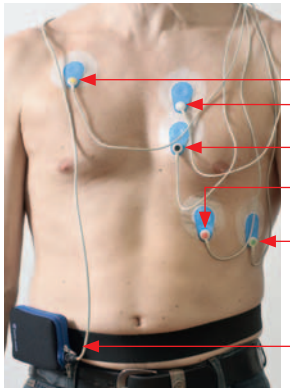

3. En respectant le code couleur, relier les câbles comme indiqué sur la photo.
   - Jaune
   - Blanc
   - Noir
   - Rouge
   - Vert
4. Faire passer les câbles derrière la nuque puis le long du côté droit du corps.
   Ne pas fixer les câbles à l'aide de ruban adhésif.
5. Placer l'appareil dans l'étui de protection et le fixer avec la ceinture autour du ventre.

Mise en marche de l'appareil

1. Allumer l'appareil.
   Mettre l'interrupteur noir sur position I.
   Ne plus éteindre l'appareil.
2. Démarrer l'enregistrement :
   Appuyez pendant 10 secondes sur le bouton **jaune** jusqu'à ce qu'un triple bip confirme le début de l'enregistrement.
3. Eteindre l'appareil au bout de 24 heures (position 0), l'enlever et le renvoyer